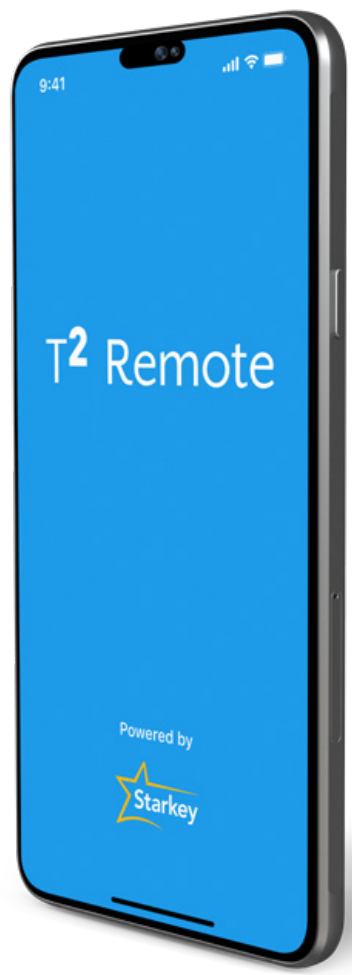
Uw T2 Afstandsbediening



Krijg volledige controle over uw hoortoestellen om u beter te laten horen en beter te laten

Inhoudsopgave

1. Aan de slag

Compatibiliteit 3

2. Overzicht startpagina 4

3. Info

Over & privacy 6

4. Aanvullende richtlijnen

Veiligheidsinformatie 7

Regelgevende informatie 9

Compatibiliteit

Voor optimale prestaties raden we aan de meest recente softwareversie beschikbaar voor uw apparaat te gebruiken.

Appel

iPhone, iPad, iPod

- De app werkt op alle versies van iOS & iPadOS 16.0 of later.

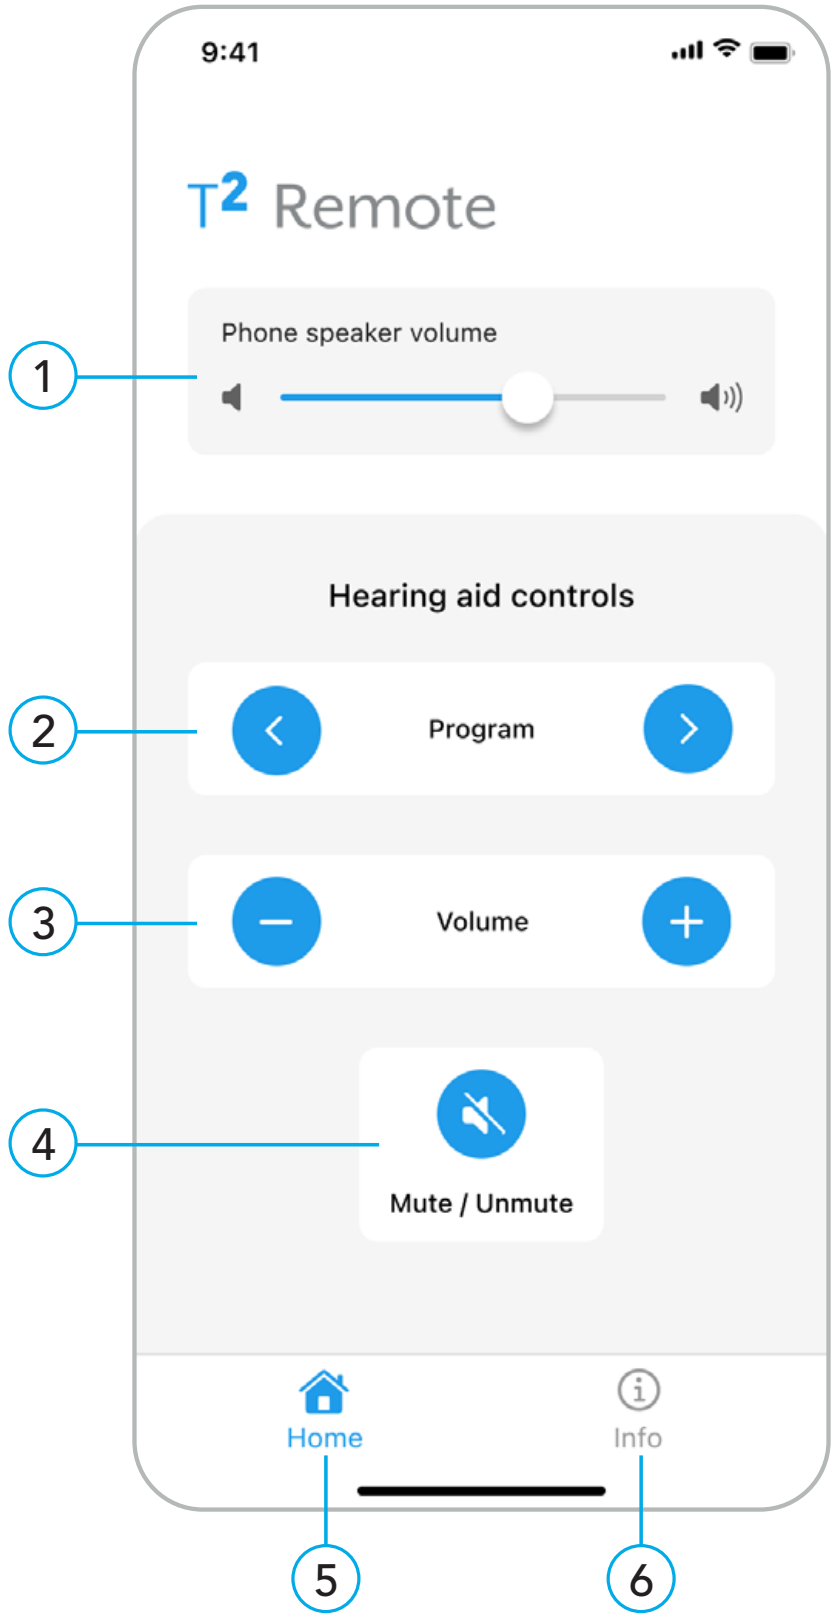
Android

- De app werkt op alle versies van Android 8.0 of later.

Overzicht startpagina

Vind de belangrijkste functies die het gebruik van uw hoortoestel verbeteren op het **Startscherm**.

1. Telefoon luidspreker volume
2. Programma
3. Volume
4. Dempen / Dempen opheffen
5. Startpagina
6. Info: *App-rondleiding, Klantenservice, ingebouwde*


9:41
T2 Remote
Phone speaker volume
Hearing aid controls
Program
Volume
Mute / Unmute
Home
Info
1
2
3
4
5
6

Uw **Over & privacy** scherm laat u informatie zien over deze app, gebruikersrichtlijnen en overeenkomsten. Deze omvatten:

- **Over**

  Dit geeft je informatie over het doel van je app en de app-fabrikant, Starkey Laboratories, Inc.
- **Privacybeleid**

  Dit beschrijft uw recht op privacy in overeenstemming met privacy- en beschermingswetten.
- **EULA (Eindgebruikerslicentieovereenkomst)**
  Dit is een overeenkomst met de fabrikant over de manieren waarop u de app kunt gebruiken.
- **Toestemmingen**

  Hiermee kunt u uw toestemmingen voor het delen van specifieke soorten gegevens bekijken en bewerken. Door toestemming te geven voor het delen van analyses kan de app-fabrikant verbeteringen aanbrengen door gegevens te verzamelen over hoe de app wordt gebruikt.

⚠ **WAARSCHUWING:** Het geluid mag niet onaangenaam of pijnlijk zijn. U moet het volume verlagen of het apparaat verwijderen als het geluid onaangenaam hard of pijnlijk is. Als u het volume steeds moet verlagen, moet u mogelijk uw apparaat verder aanpassen.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS VAN HOORAPPARATEN:

Het is een goede gezondheidspraktijk voor een persoon met gehoorverlies om een medische evaluatie te ondergaan door een erkende arts (bij voorkeur een arts die gespecialiseerd is in ziekten van het oor) voordat een hoortoestel op recept wordt aangeschaft. Erkende artsen die gespecialiseerd zijn in ziekten van het oor worden vaak aangeduid als keel-, neus- en oorartsen, otologen of otorinolaryngologen. Het doel van de medische evaluatie is om ervoor te zorgen dat alle medisch behandelbare aandoeningen die het gehoor kunnen beïnvloeden, worden geïdentificeerd en behandeld voordat het hoortoestel wordt aangeschaft.

Na de medische evaluatie zal de arts u een schriftelijke verklaring geven waarin staat dat uw gehoorverlies medisch is beoordeeld en dat u mogelijk in aanmerking komt voor een hoortoestel. De arts zal u, indien van toepassing, doorverwijzen naar een audioloog of hoortoestelverstrekker voor een evaluatie van het hoortoestel.

De audioloog of hoortoestelverstrekker zal een hoortoestelbeoordeling uitvoeren om uw vermogen om te horen met en zonder hoortoestel te beoordelen.

De evaluatie van het hoortoestel stelt de audicien of leverancier in staat om een hoortoestel te selecteren en aan te passen aan uw individuele behoeften.

Als u twijfels heeft over uw vermogen om zich aan te passen aan versterking, moet u informeren naar de beschikbaarheid van een proefhuur- of aankoopoptieprogramma. Veel audiciens bieden tegenwoordig programma's aan waarmee u een hoortoestel voor een bepaalde periode tegen een nominale vergoeding kunt dragen, waarna u kunt beslissen of u het hoortoestel wilt kopen.

In sommige gebieden moet u een medische evaluatie ondergaan voordat u een hoortoestel op recept koopt. Sommige staten staan een volwassene toe om af te zien van de medische evaluatie.

Een hoortoestel zal het normale gehoor niet herstellen en zal een gehoorstoornis als gevolg van organische aandoeningen niet voorkomen of verbeteren. Het gebruik van een hoortoestel is slechts een onderdeel van gehoorhabilitatie en kan aangevuld moeten worden met auditieve training en instructie in liplezen. In de meeste gevallen maakt zelden gebruik van een hoortoestel het voor de gebruiker niet mogelijk om er volledig van te profiteren.

⚠ **WAARSCHUWING:** Als het is ingesteld op het maximale uitgangsniveau en gedurende langere tijd wordt gedragen dan hieronder aanbevolen, kan de blootstelling van

de patiënt aan geluidsenergie de geluidsblootstellingslimieten overschrijden. Dit instrument is bedoeld voor gebruik gedurende maximaal zestien (16) uur per dag wanneer het is ingesteld op het maximale uitgangsniveau.

Melden van bijwerkingen

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden in verband met uw Starkey-apparaat moet worden gemeld aan uw lokale Starkey-vertegenwoordiger en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u gevestigd bent. Een ernstig incident wordt gedefinieerd als elke storing, verslechtering van de kenmerken en/of prestaties van het apparaat, of ontoereikendheid in de gebruiksaanwijzing/etikettering van het apparaat die kan leiden tot de dood of ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van de gebruiker, OF dit bij herhaling zou kunnen veroorzaken.

Voorgeschreven Gebruik

De T2-afstandsbediening is bedoeld om een gebruiker in staat te stellen het volume, de programmakeuze en het dempen/ontdemping van T2-compatibele hoortoestellen op afstand te bedienen.

Indicaties voor gebruik

De T2 Remote is een optioneel programma bedoeld voor patiënten die T2-compatibele hoortoestellen gebruiken en die een iOS- of Android-apparaat willen gebruiken als afstandsbediening.

Beoogde gebruiker en gebruikersomgeving

Leekpersonen in een thuissituatie.

Klinisch voordeel

De T2 Remote zelf biedt geen direct klinisch voordeel. Een indirect klinisch voordeel wordt geboden doordat de hoortoestellen hun beoogde functie kunnen vervullen.

IFU van toepassing op het volgende:

- Starkey: Picasso, Evolv AI, Genesis AI, Signature Series, Edge AI, G Series AI, Omega AI
- Audibel: DaVinci, Arc AI, Intrigue AI, Signature Series, Vitality AI, A Series AI, Aris AI
- NuEar: Canvas, Savant, NE NXG AI, Signature Series, Edge AI, NE Series AI, Nobel AI
- MicroTech: Portret, MicroTech Envy, MT NGX AI, Signature Series, Edge AI
- SOORT: KINDvitalo & KINDvaro, KINDviano x, KINDviano
- Pro Akustik: ipro AI
- Telefunken: Vation & TF10-2 Plus X, TF8-2 Plus, TF7-5 Plus X, TF5-2 Plus X, TF3-2 Plus X
- Audigy: AGXs pi, AGXs Evolv AI, AGXs Genesis AI, Signature Series, Edge AI, G Series AI, Omega AI

Beveiligingsmelding

Patiëntgegevens zijn privé en de bescherming ervan is belangrijk, raadpleeg daarom het volgende:

- Zorg ervoor dat smartphones up-to-date worden gehouden met de nieuwste beveiligingsupdates van het besturingssysteem.

Regelgevende

Voor service of reparatie neemt u eerst contact op met uw audicien. Indien nodig kunt u uw hoortoestellen sturen naar:

Fabrikant volgens FDA en EU Verordening Medische Hulpmiddelen 2017/745
Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com

EC REP


Starkey Laboratories (Duitsland) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Duitsland

CH REP

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Zwitserland

VK Geautoriseerde Persoon:
Starkey VK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, VK

Fabrikant volgens Health Canada
Starkey Labs Canada Co.
2476 Argentia Road, Suite 301
Mississauga, ON L5N 6M1
www.starkeycanada.ca

Symbool	Betekenis van het symbool	Toepasselijke norm	Symboolnummer
	Fabrikant	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Importeur	BS EN ISO 15223- 1:2021	5.1.8
	Land van Fabricage	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Productiedatum	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Catalogusnummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Serienummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medisch Hulpmiddel	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Droog houden	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperatuurlimiet	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Vochtigheidsbeperking	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Voorzichtigheid	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Algemeen waarschuwingsbord	EC 60601-1, Referentienummer Tabel D.2, Veiligheidsteken 2	ISO 7010-W001
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/ handleiding	EC 60601-1, Referentienr. Tabel D.2, Veiligheidsteken 10	ISO 7010-M002
	Apart inzamelen	RICHTLIJN 201 2/19/EU (WEEE)	Bijlage IX
	Klasse II apparatuur	IEC 60417 Referentienummer Tabel D.1	Symbool 9 (IEC 60417- 5172)
	Regelgevende conformiteitsmarkering (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N.v.t.
	UKCA-markering	SI 2002 Nr. 618, zoals gewijzigd (UK MDR 2002)	N.v.t.
	Giteki Mark	Japanse Radiowet	N.v.t.
	Gelijkstroom	IEC 60601-1 Referentienummer Tabel D.1	IEC 60417-5031
	Recyclingsymbool	Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad	Bijlagen I-VII
	Recyclingsymbool voor elektrische apparatuur en draagbare batterijen	Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad	Bijlagen I-VII
	NOM-certificeringssymbool	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabel D.3	Code 2
IPN_1N_2	Beschermingsgraad	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabel D.3	Code 2
	Korea KCC-markering		
	Vertaling	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

Notities

Om toegang te krijgen tot een elektronische versie van deze gebruikershandleiding, bezoekt u alstublieft: https://eifu.starkey.com/eifu/

CE
2797

Starkey zijn handelsmerken van Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden. P00000365 11/25 BKLT3261-01-EN-XX