
Uw T2 Remote gebruikershandleiding

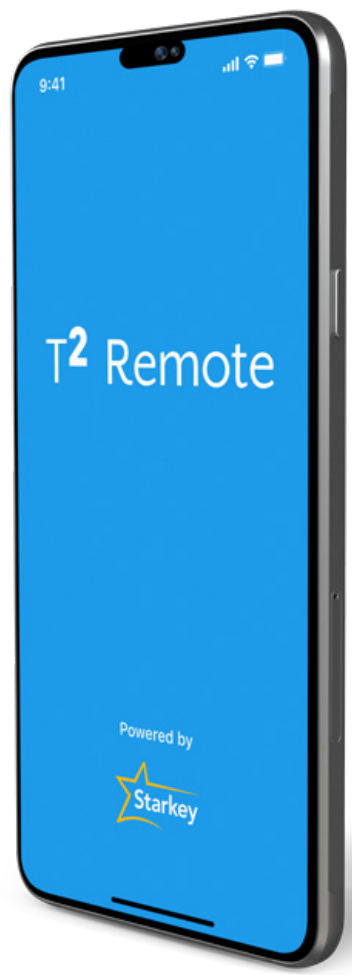

Krijg volledige controle over uw hoortoestellen
om u te helpen beter te horen en beter te leven

Inhoudsopgave

1. Aan de slag

Compatibiliteit 3

2. Overzicht van de woning 4

3. Info

Over & privacy 6

4. Aanvullende richtlijnen

Veiligheidsinformatie 7

Regelgevende informatie 9

Compatibiliteit

Voor de beste prestaties raden we aan de meest recente softwareversie te gebruiken die beschikbaar is voor uw apparaat.

Apple

iPhone, iPad, iPod

- De app werkt op alle versies van iOS & iPadOS 16.0 of hoger.

Android


- De app werkt op alle versies van Android 8.0 of hoger.

Overzicht van Home

Vind de belangrijkste functies die uw hoortoestelgebruik verbeteren op het **startscherm**.

1. Telefoonluidsprekervolume
2. Programma
3. Volume
4. Dempen
5. Dempen opheffen
6. Edge Mode+ uit/aan*
7. Alle wijzigingen resetten*
8. Start
9. Info: *Rondleiding door de app, klantenondersteuning, gebruikershandleiding in de app*

**Functie kan per hoortoestelmodel verschillen*

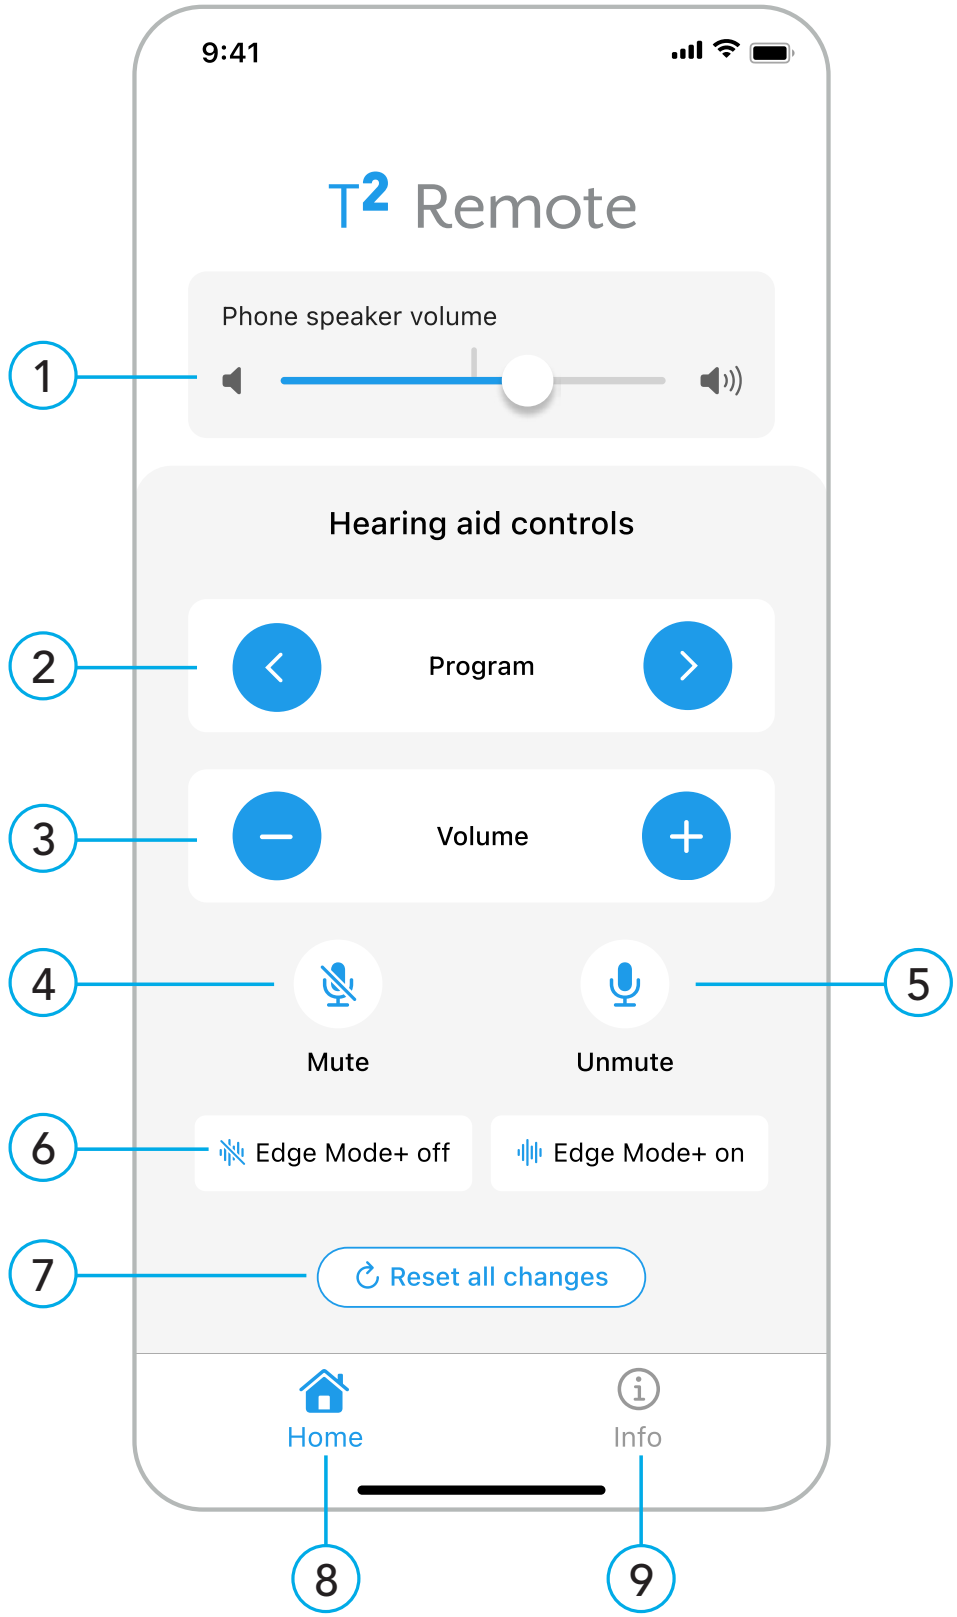
9:41
T2 Remote
Phone speaker volume
1
Hearing aid controls
2
Program
3
Volume
4
Mute
5
Unmute
6
Edge Mode+ off
Edge Mode+ on
7
Reset all changes
Home
Info
8
9

Uw **informatiescherm** scherm laat u informatie over deze app, gebruikersrichtlijnen en overeenkomsten bekijken. Deze omvatten:

- **App-rondleiding:** Bekijk een begeleide rondleiding door de opties op je startpagina.
- **Over & privacy:** Details over het maken van de app, het privacybeleid, de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en toestemmingsopties.
- **Klantenondersteuning:** Optie om een e-mail te sturen naar de klantenondersteuning voor extra hulp indien nodig.
- **Gebruikershandleiding:** Gedetailleerde handleiding van de app die volledig doorzoekbaar is.

⚠ **WAARSCHUWING:** Het geluid mag niet oncomfortabel of pijnlijk zijn. U moet het volume zachter zetten of het apparaat verwijderen als het geluid oncomfortabel hard of pijnlijk is. Als u het volume voortdurend moet verlagen, moet u mogelijk uw apparaat verder aanpassen.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR TOEKOMSTIGE HOORTOESTELGEBRUIKERS:

Het is een goede gezondheidspraktijk voor iemand met gehoorverlies om vóór de aankoop van een op recept verkrijgbare hoortoestel een medische evaluatie te laten uitvoeren door een bevoegde arts (bij voorkeur een arts die gespecialiseerd is in aandoeningen van het oor). Bevoegde artsen die gespecialiseerd zijn in aandoeningen van het oor worden vaak aangeduid als otolaryngologen, otologen of otorhinolaryngologen. Het doel van de medische evaluatie is ervoor te zorgen dat alle medisch behandelbare aandoeningen die het gehoor kunnen beïnvloeden, worden geïdentificeerd en behandeld voordat het hoortoestel wordt gekocht.

Na de medische evaluatie zal de arts u een schriftelijke verklaring geven waarin staat dat uw gehoorverlies medisch is geëvalueerd en dat u mogelijk in aanmerking komt als kandidaat voor een hoortoestel. De arts zal u, indien van toepassing, doorverwijzen naar een audioloog of hoortoestellenverstrekker voor een hoortoestelevaluatie.

De audioloog of hoortoestellenverstrekker zal een hoortoestelevaluatie uitvoeren om uw vermogen om te horen met en zonder hoortoestel te beoordelen.

De hoortoestelevaluatie stelt de audioloog of verstrekker in staat een hoortoestel te selecteren en aan te passen aan uw individuele behoeften.

Als u twijfels hebt over uw vermogen om zich aan versterking aan te passen, dient u te informeren naar de beschikbaarheid van een proefhuur- of aankoopoptieprogramma. Veel hoortoestellenverstrekkers bieden tegenwoordig programma's aan waarmee u gedurende een bepaalde periode een hoortoestel kunt dragen tegen een geringe vergoeding, waarna u kunt beslissen of u het hoortoestel wilt kopen.

In sommige regio's moet u vóór de aankoop van een op recept verkrijgbaar hoortoestel een medische evaluatie ondergaan. Sommige staten staan een volwassene toe om afstand te doen van de medische evaluatie.

Een hoortoestel herstelt het normale gehoor niet en voorkomt of verbetert geen gehoorbeperking die het gevolg is van organische aandoeningen. Het gebruik van een hoortoestel is slechts een onderdeel van gehoorrevalidatie en moet mogelijk worden aangevuld met gehoortraining en instructie in liplezen. In de meeste gevallen stelt onregelmatig gebruik van een hoortoestel de gebruiker niet in staat er volledig voordeel uit te halen.

⚠ **WAARSCHUWING:** Als het apparaat op het maximale uitgangsniveau is ingesteld en gedurende perioden wordt gedragen die langer zijn dan de onderstaande aanbevelingen, kan de blootstelling van de patiënt aan geluidsenergie de limieten voor blootstelling aan lawaai overschrijden. Dit instrument is bedoeld voor gebruik gedurende maximaal zestien (16) uur per dag wanneer het is ingesteld op het maximale uitgangsniveau.

Melden van bijwerkingen

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met uw Starkey-apparaat moet worden gemeld aan uw lokale Starkey-vertegenwoordiger en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u gevestigd bent. Een ernstig incident wordt gedefinieerd als elke storing, verslechtering van de kenmerken en/of prestaties van het apparaat, of tekortkoming in de gebruiksaanwijzing/etikettering van het apparaat die kan leiden tot overlijden of ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van de gebruiker, OF dit kan veroorzaken bij herhaling.

Beoogd gebruik

De T2 Remote is bedoeld om een gebruiker op afstand het volume, de programmaselectie en het dempen/opheffen van dempen van T2-compatibele hoortoestellen te laten bedienen.

Indicaties voor gebruik

De T2 Remote is een optioneel programma dat is bedoeld voor patiënten die T2-compatibele hoortoestellen gebruiken en die een iOS- of Android-apparaat willen gebruiken als afstandsbediening.

Beoogde gebruiker en gebruikersomgeving

Leekpersonen in een thuisomgeving.

Klinisch voordeel

De T2 Remote zelf biedt geen direct klinisch voordeel. Een indirect klinisch voordeel wordt geboden doordat de hoortoestellen in staat worden gesteld hun beoogde doel te bereiken.

Gebruiksaanwijzing van toepassing op het volgende:

- Starkey: Picasso, Evolv AI, Genesis AI, Signature Series, Edge AI, G Series AI, Omega AI, Omega AI+
- Audibel: DaVinci, Arc AI, Intrigue AI, Signature Series, Vitality AI, A Series AI, Aris AI, Aris AI+
- NuEar: Canvas, Savant, NE NXG AI, Signature Series, Edge AI, NE Series AI, Noble AI, Noble AI+
- MicroTech: Portrait, MicroTech Envy, MT NGX AI, Signature Series, Edge AI
- KIND: KINDvitalo & KINDvaro, KINDviano x, KINDviano
- Pro Akustik: ipro AI
- Telefunken: Vation & TF10-2 Plus X, TF8-2 Plus, TF7-5 Plus X, TF5-2 Plus X, TF3-2 Plus X
- Audigy: AGXs pi, AGXs Evolv AI, AGXs Genesis AI, Signature Series, Edge AI, G Series AI, Omega AI

Veiligheidsmelding

Patiëntgegevens zijn privé en bescherming ervan is belangrijk, daarom verwijzen wij u naar het volgende:

- Zorg ervoor dat smartphones up-to-date blijven met de nieuwste beveiligingsupdates voor het besturingssysteem.

Voor service of reparatie neemt u eerst contact op met uw hoorzorgprofessional. Indien nodig kunt u uw hoortoestellen opsturen naar:

Fabrikant volgens FDA en EU-verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen Starkey Laboratories, Inc. 6700 Washington Ave. South Eden Prairie, MN 55344 VS www.starkey.com

EC REP

Starkey Laboratories (Duitsland) GmbH Weg der Arbeit 218-222 22335 Hamburg Duitsland

UK-gedagtoriseerde persoon: Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, VK
www.starkey.co.uk

CH REP

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

Fabrikant volgens Health Canada Starkey Labs Canada Co. 2476 Argentia Road, Suite 301 Mississauga, ON L5N 6M1 www.starkeycanada.ca

Symbool	Betekenis van het symbool	Toepasselijke norm	Symboolnummer
	Fabrikant	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
EC REP	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Importeur	BS EN ISO 15223- 1:2021	5.1.8
MX	Land van fabricage	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Fabricagedatum	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
REF	Catalogusnummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
SN	Serienummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
MD	Medisch hulpmiddel	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Droog houden	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperatuurlimiet	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Vochtigheidslimiet	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Let op	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Algemeen waarschuwingssymbool	EC 60601-1, Referentienr. Tabel D.2, veiligheidssymbool 2	ISO 7010-W001
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/ bijsluiter	EC 60601-1, Referentienr. Tabel D.2, veiligheidssymbool 10	ISO 7010-M002
	Gescheiden inzamelen	RICHTLIJN 201 2/19/EU (AEEA)	Bijlage IX
	Apparatuur van klasse II	IEC 60417 Referentienr. Tabel D.1	Symbool 9 (IEC 60417- 5172)
	Markering van naleving van regelgeving (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N.v.t.
UK CA	UKCA-markering	SI 2002 nr. 618, zoals gewijzigd (UK MDR 2002)	N.v.t.
	Giteki-markering	Japanse radiowet	N.v.t.
	Gelijkstroom	IEC 60601-1 Referentienr. Tabel D.1	IEC 60417-5031
06 PS	Recyclingsymbool	Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad	Bijlage I-VII
	Recyclingsymbool voor elektrische apparatuur en draagbare batterijen	Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad	Bijlage I-VII
NOM	NOM-certificeringssymbool	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabel D.3	Code 2
IPN_1N_2	Beschermingsgraad	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabel D.3	Code 2
	Korea KCC-markering		
A → 文	Vertaling	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

Opmerkingen

Ga voor toegang tot een elektronische versie van deze gebruikershandleiding naar: https://eifu.starkey.com/eifu/

CE
2797

Starkey en T2 Remote zijn handelsmerken van Starkey Laboratories, Inc.

©2026 Starkey Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden. P00000365 4/26 BKLT3261-02-EN-XX Octrooi: www.starkey.com/patents