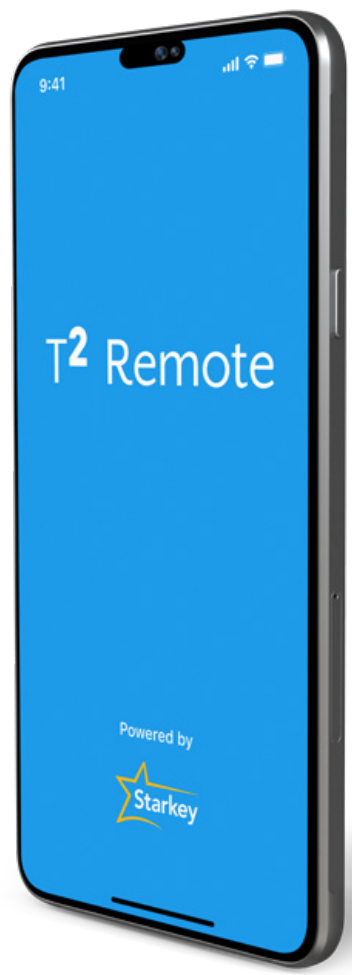
Din bruker-manual for T2 Remote



Få full kontroll over høreapparatene dine for å hjelpe deg å høre bedre og leve bedre

Table of contents

1. Get started

Kompatibilitet 3

2. Hjemmeoversikt 4

3. Info

Om og personvern 6

4. Tilleggsveiledning

Sikkerhetsinformasjon 7

Regulatorisk informasjon 9

Kompatibilitet

For best ytelse anbefaler vi å bruke den nyeste programvareversjonen som er tilgjengelig for enheten din.

Apple

iPhone, iPad, iPod

- Appen kjører på alle versjoner av iOS og iPadOS 16.0 eller nyere.

Android

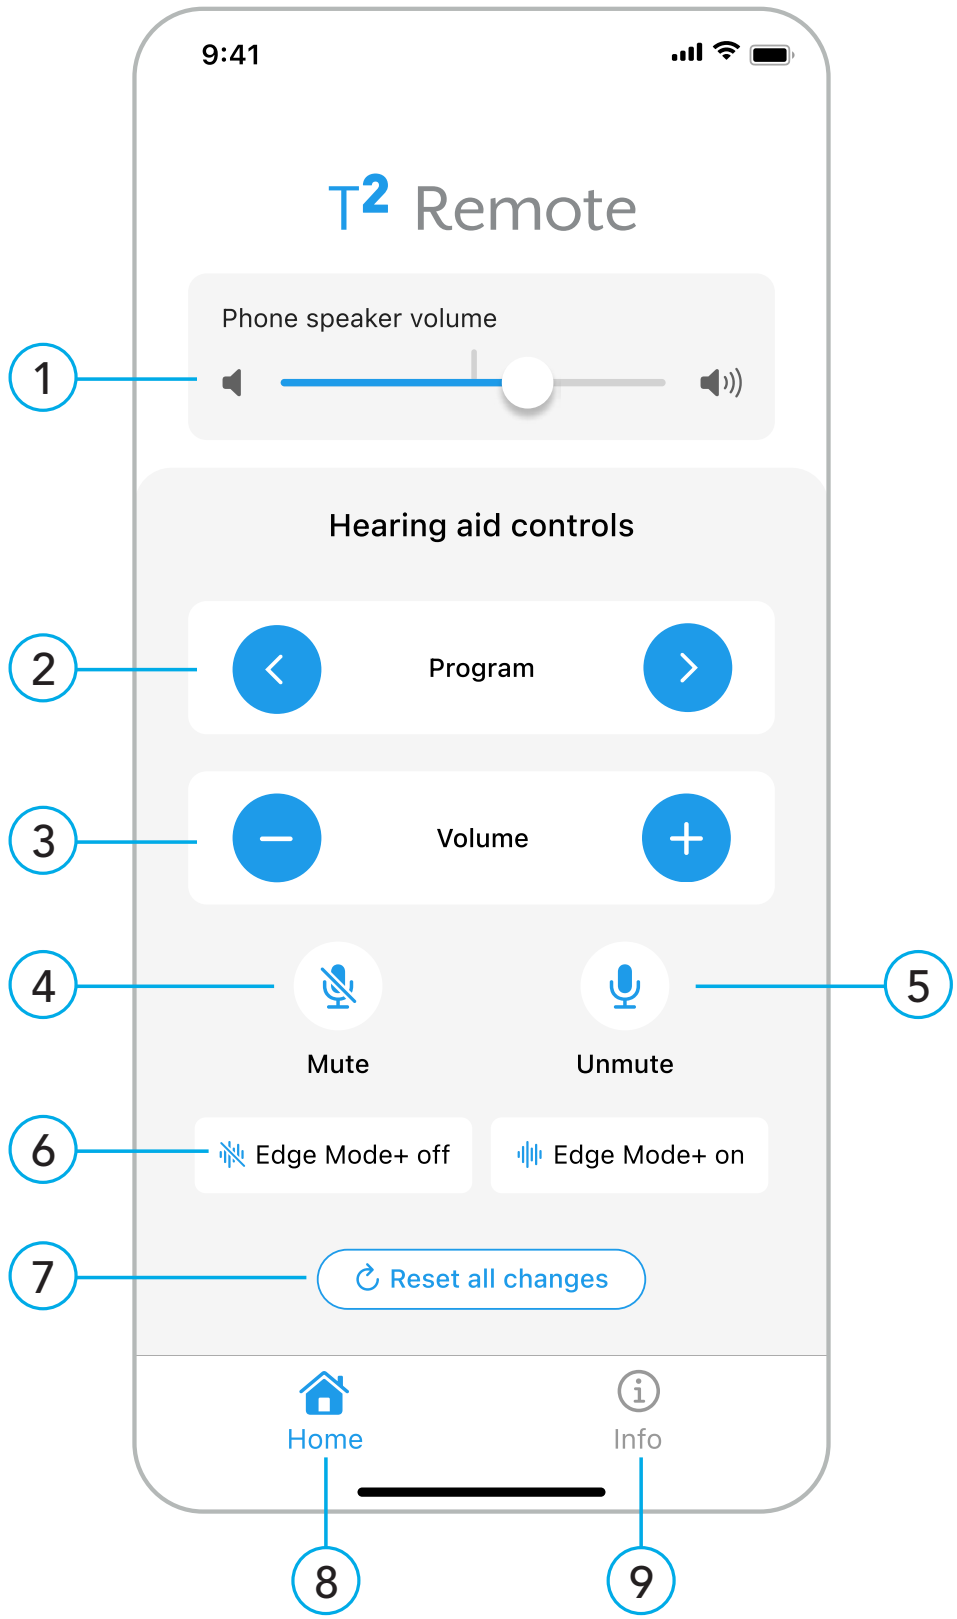
- Appen kjører på alle versjoner av Android 8.0 eller nyere.

Oversikt over hjem

Finn de viktigste funksjonene som forbedrer bruken av høreapparatet ditt på **hjemskjermen**.

1. Volum for telefonhøyttaler
2. Program
3. Volum
4. Demp
5. Opphev demping
6. Edge Mode+ av/på*
7. Tilbakestill alle endringer*
8. Hjem
9. Info: *Omvisning i appen, kundestøtte, brukerveiledning i appen*

**Funksjonen kan variere avhengig av høreapparatmodell*


9:41
T2 Remote
Phone speaker volume
1
Hearing aid controls
2
Program
3
Volume
4
Mute
5
Unmute
6
Edge Mode+ off
Edge Mode+ on
7
Reset all changes
Home
Info
8
9

Din **informasjonsskjerm** skjerm lar deg se informasjon om denne appen, brukerveiledninger og avtaler. Disse inkluderer:

- **Omvisning i appen:** Se en guidet omvisning gjennom alternativene på startsiden din.
- **Om og personvern:** Detaljer om appopprettelse, personvernerklæring, lisensavtale for sluttbrukere og samtykkealternativer.
- **Kundestøtte:** Mulighet til å sende e-post til kundestøtte for ytterligere hjelp ved behov.
- **Brukerveiledning:** Detaljert veiledning for appen som er fullt søkbar.

⚠ **ADVARSEL:** Lyden skal ikke være ubehagelig eller smertefull. Du bør skru ned volumet eller fjerne enheten hvis lyden er ubehagelig høy eller smertefull. Hvis du konsekvent må skru ned volumet, kan det hende du må justere enheten ytterligere.

VIKTIG MELDING TIL POTENSIELLE BRUKERE AV HØREAPPARAT:

Det er god helsepraksis for en person med hørselstap å få en medisinsk vurdering av en autorisert lege (helst en lege som spesialiserer seg på øresykdommer) før man kjøper et reseptbelagt høreapparat. Autoriserte leger som spesialiserer seg på øresykdommer omtales ofte som otolaryngologer, otologer eller otorhinolaryngologer. Formålet med den medisinske vurderingen er å sikre at alle medisinsk behandlingsbare tilstander som kan påvirke hørselen, blir identifisert og behandlet før høreapparatet kjøpes.

Etter den medisinske vurderingen vil legen gi deg en skriftlig erklæring som sier at hørselstapet ditt er medisinsk vurdert, og at du kan anses som en kandidat for et høreapparat. Legen vil henvise deg til en audiograf eller høreapparatdispenser, etter behov, for en høreapparatvurdering.

Audiografen eller høreapparatdispenseren vil gjennomføre en høreapparatvurdering for å vurdere evnen din til å høre med og uten høreapparat.

Høreapparatvurderingen vil gjøre det mulig for audiografen eller dispenseren å velge og tilpasse et høreapparat til dine individuelle behov.

Hvis du er usikker på om du vil klare å venne deg til forsterkning, bør du spørre om det finnes et prøveleie- eller kjøpsalternativprogram. Mange høreapparatdistributører tilbyr nå programmer som lar deg bruke et høreapparat i en periode mot et nominelt gebyr, og deretter kan du bestemme om du vil kjøpe høreapparatet.

I noen områder må du ha en medisinsk vurdering før du kjøper et reseptbelagt høreapparat. Noen stater tillater at en voksen kan frasi seg den medisinske vurderingen.

Et høreapparat vil ikke gjenopprette normal hørsel og vil ikke forhindre eller forbedre en hørselshemming som skyldes organiske tilstander. Bruk av høreapparat er bare en del av hørselsrehabilitering og kan måtte suppleres med auditiv trening og opplæring i leppeavlesning. I de fleste tilfeller vil sjelden bruk av et høreapparat ikke gjøre det mulig for brukeren å oppnå full nytte av det.

⚠ **ADVARSEL:** Hvis det er innstilt på maksimalt utgangsnivå og brukes i perioder som overstiger anbefalingene nedenfor, kan pasientens eksponering for lydenergi potensielt overstige grensene for støyeksponering. Dette instrumentet er beregnet for bruk i maksimalt seksten (16) timer per dag når det er innstilt på maksimalt utgangsnivå.

Rapportering av bivirkninger

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med Starkey-enheten din, bør rapporteres til din lokale Starkey-representant og den kompetente myndigheten i medlemsstaten der du er etablert. En alvorlig hendelse er definert som enhver feilfunksjon, forringelse av enhetens egenskaper og/eller ytelse, eller utilstrekkelighet i enhetens bruksanvisning/merking som kan føre til død eller alvorlig forverring av brukerens helsetilstand, ELLER kan gjøre det ved gjentakelse.

Tiltenkt bruk

T2 Remote er ment å gi en bruker mulighet til å fjernstyre volum, programvalg og demping/oppheving av demping på T2-aktiverte høreapparater.

Indikasjoner for bruk

T2 Remote er et valgfritt program beregnet for pasienter som bruker T2-aktiverte høreapparater og som ønsker å bruke en iOS- eller Android-enhet som fjernkontroll.

Tiltenkt bruker og bruksmiljø

Lekfolk i et hjemmemiljø.

Klinisk nytte

T2 Remote i seg selv gir ikke direkte klinisk nytte. En indirekte klinisk nytte oppnås ved å gjøre det mulig for høreapparatene å oppfylle sitt tiltenkte formål.

Bruksanvisning gjelder for følgende:

- Starkey: Picasso, Evolv AI, Genesis AI, Signature Series, Edge AI, G Series AI, Omega AI, Omega AI+
- Audibel: DaVinci, Arc AI, Intrigue AI, Signature Series, Vitality AI, A Series AI, Aris AI, Aris AI+
- NuEar: Canvas, Savant, NE NXG AI, Signature Series, Edge AI, NE Series AI, Noble AI, Noble AI+
- MicroTech: Portrait, MicroTech Envy, MT NGX AI, Signature Series, Edge AI
- KIND: KINDvitalo & KINDvaro, KINDviano x, KINDviano
- Pro Akustik: ipro AI
- Telefunken: Vation & TF10-2 Plus X, TF8-2 Plus, TF7-5 Plus X, TF5-2 Plus X, TF3-2 Plus X
- Audigy: AGXs pi, AGXs Evolv AI, AGXs Genesis AI, Signature Series, Edge AI, G Series AI, Omega AI

Sikkerhetsmerknad

Pasientdata er private, og beskyttelse av dem er viktig, derfor vennligst se følgende:

- Sørg for at smarttelefoner holdes oppdatert med de nyeste sikkerhetsoppdateringene for operativsystemet.
- Sørg for at den installerte appversjonen din er oppdatert.
- Bruk bare Starkey-apper fra offisielle butikker sammen med høreapparatene dine.
- Sørg for at installerte apper bare har de tillatelsene de trenger.
- Ikke bruk en jailbroken telefon for å sikre at data alltid holdes trygge.
- Beskytt sikkerhetskopiene av smarttelefonen din mot datatap og tyveri.
- Fjern alle data fra smarttelefonen hvis den ikke lenger skal brukes av deg, eller hvis den skal kastes.

Vær oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste.

Regulatorisk

For service or repair, please contact your hearing care professional first.
If necessary, you can send your hearing aids to:

Manufacturer according to FDA and EU Medical Device Regulation 2017/745
Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com

EC REP


Starkey Laboratories (Germany) GmbH Weg bei Jäger 218-222, 22335 Hamburg
Tyskland

UK-autorisert person:
Starkey UK William F. Austin House 8 Upper 33
Hazel Grove Stockport
SK7 5BX, Storbritannia
www.starkey.co.uk

CH REP

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

Manufacturer according to Health Canada
Starkey Labs Canada Co.
2476 Argentia Road, Suite 301
Mississauga, ON L5N 6M1
www.starkeycanada.ca

Symbol	Symbolbetydning	Gjeldende standard	Symbolnummer
	Produsent	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Importør	BS EN ISO 15223- 1:2021	5.1.8
	Produksjonsland	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Produksjonsdato	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Katalognummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Serienummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medisinsk utstyr	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Hold tørt	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperaturgrense	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Fuktighetsbegrensning	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Forsiktig	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Generelt advarselssymbol	EC 60601-1, Referansenr. Tabell D.2, Sikkerhetssymbol 2	ISO 7010-W001
	Se bruksanvisning/hefte	EC 60601-1, Referansenr. Tabell D.2, Sikkerhetssymbol 10	ISO 7010-M002
	Samles separat	DIREKTIV 201 2/19/EU (WEEE)	Vedlegg IX
	Utstyr i klasse II	IEC 60417 Referansenr. Tabell D.1	Symbol 9 (IEC 60417- 5172)
	Regulatorisk samsvarsmerke (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	I/A
	UKCA-merke	SI 2002 nr. 618, med endringer (UK MDR 2002)	I/A
	Giteki-merke	Japansk radiolov	I/A
	Likestrøm	IEC 60601-1 Referansenr. Tabell D.1	IEC 60417-5031
	Resirkuleringssymbol	Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF	Vedlegg I-VII
	Resirkuleringssymbol for elektrisk utstyr og bærbare batterier	Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF	Vedlegg I-VII
	NOM-sertifiseringssymbol	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabell D.3	Kode 2
IPN1N2	Beskyttelsesgrad	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabell D.3	Kode 2
	Korea KCC-merke		
	Oversettelse	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

Notater

For å få tilgang til en elektronisk versjon av denne brukerveiledningen, besøk:
https://eifu.starkey.com/eifu/

CE
2797

Starkey og T2 Remote er varemerker tilhørende Starkey Laboratories, Inc.

©2026 Starkey Laboratories, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. P00000365 4/26 BKLT3261-02-EN-XX Patent: www.starkey.com/patents