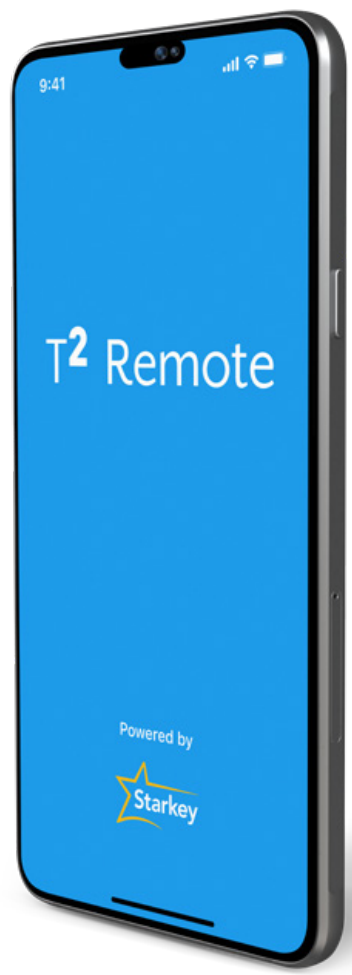
Seu Manual do Usuário T2 Re-mote



Obtenha controle total sobre seus aparelhos auditivos para ajudá-lo a ouvir melhor e viver

Sumário

1. Comece

Compatibilidade 3

2. Visão geral da casa 4

3. Informações

Sobre e privacidade 6

4. Orientações adicionais

Informações de segurança 7

Informações regulatórias 9

Compatibilidade

Para melhor desempenho, recomendamos usar a versão de software mais recente disponível para o seu dispositivo.

Apple

iPhone, iPad, iPod

- O aplicativo funciona em todas as versões do iOS e iPadOS 16.0 ou posteriores.

Android

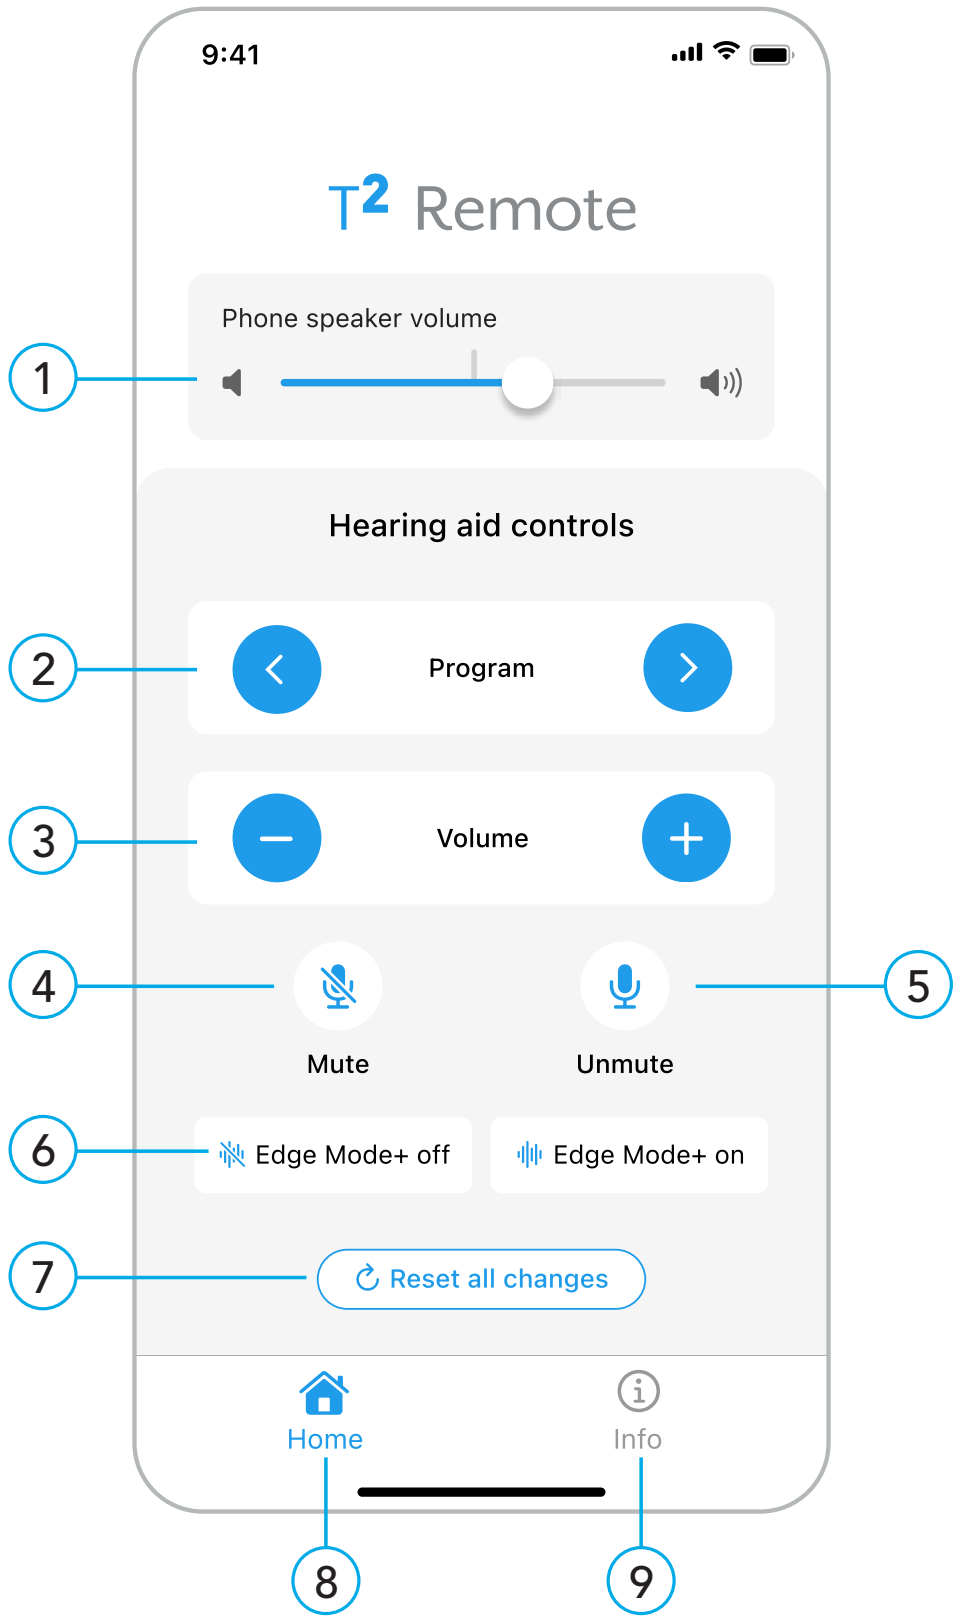
- O aplicativo funciona em todas as versões do Android 8.0 ou posteriores.

Visão geral da página inicial

Encontre os principais recursos que aprimoram o uso do seu aparelho auditivo na **tela inicial**.

1. Volume do alto-falante do telefone
2. Programa
3. Volume
4. Mudo
5. Ativar som
6. Edge Mode+ desativado/ativado*
7. Redefinir todas as alterações*
8. Início
9. Informações: *Tour do app, suporte ao cliente, guia do usuário no app*

**O recurso pode variar de acordo com o modelo do aparelho auditivo*


9:41
T2 Remote
Phone speaker volume
1
Hearing aid controls
2
Program
3
Volume
4
Mute
5
Unmute
6
Edge Mode+ off
Edge Mode+ on
7
Reset all changes
Home
Info
8
9

Seu **tela de Informações** permite que você veja informações sobre este app, diretrizes do usuário e acordos. Estes incluem:

- **Tour do app:** Revise um tour guiado pelas opções da sua página inicial.
- **Sobre e privacidade:** Detalhes sobre a criação do app, política de privacidade, Contrato de Licença de Usuário Final e opções de consentimento.
- **Suporte ao cliente:** Opção de enviar um e-mail ao suporte ao cliente para obter ajuda adicional, conforme necessário.
- **Guia do usuário:** Guia detalhado do app, totalmente pesquisável.

Informações de

⚠ **CUIDADO:** O som não deve ser desconfortável nem doloroso. Você deve diminuir o volume ou remover o dispositivo se o som estiver desconfortavelmente alto ou doloroso. Se você precisar diminuir o volume com frequência, talvez seja necessário ajustar ainda mais o seu dispositivo.

AVISO IMPORTANTE PARA USUÁRIOS EM POTENCIAL DE APARELHOS AUDITIVOS:

É uma boa prática de saúde que uma pessoa com perda auditiva faça uma avaliação médica com um médico licenciado (de preferência um médico especializado em doenças do ouvido) antes de comprar um aparelho auditivo com prescrição. Médicos licenciados especializados em doenças do ouvido são frequentemente chamados de otorrinolaringologistas, otologistas ou otorrinolaringologistas. O objetivo da avaliação médica é garantir que todas as condições tratáveis clinicamente que possam afetar a audição sejam identificadas e tratadas antes da compra do aparelho auditivo.

Após a avaliação médica, o médico lhe fornecerá uma declaração por escrito informando que sua perda auditiva foi avaliada clinicamente e que você pode ser considerado um candidato a um aparelho auditivo. O médico o encaminhará a um audiologista ou a um dispensador de aparelhos auditivos, conforme apropriado, para uma avaliação do aparelho auditivo.

O audiologista ou o dispensador de aparelhos auditivos realizará uma avaliação do aparelho auditivo para avaliar sua capacidade de ouvir com e sem um aparelho auditivo.

A avaliação do aparelho auditivo permitirá ao audiologista ou ao dispensador selecionar e ajustar um aparelho auditivo às suas necessidades individuais.

Se você tiver dúvidas sobre sua capacidade de se adaptar à amplificação, deve perguntar sobre a disponibilidade de um programa de teste com aluguel ou opção de compra. Muitos dispensadores de aparelhos auditivos agora oferecem programas que permitem que você use um aparelho auditivo por um período de tempo mediante uma taxa nominal, após o qual você pode decidir se deseja comprar o aparelho auditivo.

Em algumas localidades, é necessário fazer uma avaliação médica antes de comprar um aparelho auditivo com prescrição. Alguns estados permitem que um adulto dispense a avaliação médica.

Um aparelho auditivo não restaurará a audição normal e não impedirá nem melhorará uma deficiência auditiva resultante de condições orgânicas. O uso de um aparelho auditivo é apenas parte da habilitação auditiva e pode precisar ser complementado por treinamento auditivo e instruções de leitura labial. Na maioria dos casos, o uso infrequente de um aparelho auditivo não permite que o usuário obtenha dele todos os benefícios.

⚠ **ATENÇÃO:** Se ajustado para o nível máximo de saída e usado por períodos de tempo que excedam as recomendações abaixo, a exposição do paciente à energia sonora

pode ultrapassar os limites de exposição a ruído. Este instrumento destina-se ao uso por no máximo dezesseis (16) horas por dia quando ajustado para o nível máximo de saída.

Relato de Eventos Adversos

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao seu dispositivo Starkey deve ser relatado ao seu representante local da Starkey e à Autoridade Competente do Estado-Membro em que você está estabelecido. Um incidente grave é definido como qualquer mau funcionamento, deterioração nas características e/ou no desempenho do dispositivo, ou inadequação no Manual de Operações/rotulagem do dispositivo que possa levar à morte ou a uma deterioração grave do estado de saúde do usuário, OU possa fazê-lo em caso de recorrência.

Uso Pretendido

O T2 Remote destina-se a permitir que um usuário controle remotamente o volume, a seleção de programas e o ativar/desativar do mudo de aparelhos auditivos habilitados para T2.

Indicações de Uso

O T2 Remote é um programa opcional indicado para pacientes que usam aparelhos auditivos habilitados para T2 e que desejam usar um dispositivo iOS ou Android para servir como controle remoto.

Usuário Pretendido e Ambiente do Usuário

Leigos em um ambiente doméstico.

Benefício Clínico

O T2 Remote em si não fornece benefício clínico direto. Um benefício clínico indireto é ado ao permitir que os aparelhos auditivos alcancem sua finalidade pretendida.

O manual de instruções se aplica ao seguinte:

- Starkey: Picasso, Evolv AI, Genesis AI, Série Signature, Edge AI, G Series AI, Omega AI, Omega AI+
- Audibel: DaVinci, Arc AI, Intrigue AI, Série Signature, Vitality AI, A Series AI, Aris AI, Aris AI+
- NuEar: Canvas, Savant, NE NXG AI, Série Signature, Edge AI, NE Series AI, Noble AI, Noble AI+
- MicroTech: Portrait, MicroTech Envy, MT NGX AI, Série Signature, Edge AI
- KIND: KINDvitalo e KINDvaro, KINDviano x, KINDviano
- Pro Akustik: ipro AI
- Telefunken: Vation e TF10-2 Plus X, TF8-2 Plus, TF7-5 Plus X, TF5-2 Plus X, TF3-2 Plus X
- Audigy: AGXs pi, AGXs Evolv AI, AGXs Genesis AI, Série Signature, Edge AI, G Series AI, Omega AI

Aviso de Segurança

Os dados do paciente são privados e sua proteção é importante; portanto, consulte o seguinte:

- Certifique-se de que os smartphones estejam atualizados com as últimas atualizações de segurança do sistema operacional.
- Certifique-se de que a versão do aplicativo instalada esteja atualizada.
- Use apenas aplicativos Starkey de lojas oficiais com seus aparelhos auditivos.
- Certifique-se de que os aplicativos instalados tenham apenas as permissões de que precisam.
- Não use um telefone com jailbreak para garantir que os dados permaneçam seguros o tempo todo.

Informações

Para manutenção ou reparo, entre em contato primeiro com o seu profissional de saúde auditiva. Se necessário, você pode enviar seus aparelhos auditivos para:

Fabricante de acordo com a FDA e o Regulamento de Dispositivos Médicos da UE 2017/745 Starkey Laboratories, Inc. 6700 Washington Ave. South Eden Prairie, MN 55344 EUA www.starkey.com

EC REP



Starkey Laboratories (Alemanha) GmbH Wegelerstraße 3 22335 Hamburgo Alemanha

Pessoa Autorizada no Reino Unido: Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, Reino Unido www.starkey.co.uk

CH REP

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen Suíça

Manufacturer according to Health Canada
Starkey Labs Canada Co.
2476 Argentia Road, Suite 301
Mississauga, ON L5N 6M1
www.starkeycanada.ca

Símbolo	Significado do símbolo	Padrão aplicável	Número do símbolo
	Fabricante	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Representante autorizado na Comunidade Europeia	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Importador	BS EN ISO 15223- 1:2021	5.1.8
	País de Fabricação	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Data de Fabricação	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Número de Catálogo	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Número de Série	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Dispositivo Médico	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Manter Seco	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Limite de Temperatura	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Limitação de Umidade	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Cuidado	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Sinal geral de advertência	EC 60601-1, Número de referência da Tabela D.2, Sinal de segurança 2	ISO 7010-W001
	Consulte o manual/folheto de instruções	EC 60601-1, Número de referência da Tabela D.2, Sinal de segurança 10	ISO 7010-M002
	Coletar Separadamente	DIRETIVA 201 2/19/UE (WEEE)	Anexo IX
	Equipamento de Classe II	IEC 60417 Número de referência da Tabela D.1	Símbolo 9 (IEC 60417- 5172)
	Marca de Conformidade Regulatória (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Marca UKCA	SI 2002 Nº 618, conforme alterado (UK MDR 2002)	N/A
	Marca Giteki	Lei de Rádio Japonesa	N/A
	Corrente contínua	IEC 60601-1 Número de referência da Tabela D.1	IEC 60417-5031
	Símbolo de reciclagem	Diretiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho	Anexo I-VII
	Símbolo de reciclagem para equipamentos elétricos e baterias	Diretiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho	Anexo I-VII
	Símbolo de certificação NOM	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabela D.3	Código 2
IPN1N2	Grau de proteção	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabela D.3	Código 2
	Marca KCC da Coreia		
	Tradução	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

Notas

Para acessar uma versão eletrônica deste guia do usuário, visite: https://eifu.starkey.com/eifu/

CE
2797

Starkey e T2 Remote são marcas registradas da Starkey Laboratories, Inc.

©2026 Starkey Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados. P00000365 4/26 BKLT3261-02-EN-XX Patente: www.starkey.com/patents